


Měřicí komory

- měřicí komory zajišťují bezpečnou instalaci senzoru rosného bodu a ochraňují jej zejména před nečistotami, které by mohly vést k poškození senzoru
- určený výhradně pro senzory z našeho programu; pro aplikace na senzory jiných výrobců nás kontaktujte
- pro aplikaci na vyšší tlaky je nutné zvolit vhodnou tlakovou verzi senzoru

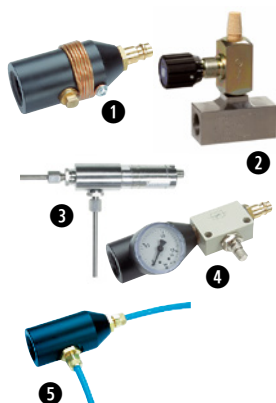

Měřicí komory			
Obj. č.	Popis	Pro senzory	Číslo
CS-06994490	standardní provedení, tlak 16 bar	DP500, DP510	1
CS-06993390	standardní provedení, tlak 16 bar	FA510, FA515, FA500	1
CS-06993590	vysokotlaká komora, tlak 350 bar	DP500, DP510, FA500, FA300-2Ex	2
CS-06993290	komora z nerezové oceli 1.4305, tlak 100 bar	FA510, FA515, FA500	3
CS-06993690	komora pro atmosférický rosný bod	DP500, DP510	4
CS-06993490	komora pro granulátové sušičky do 250 mbar	DP500, DP510	5

Sušicí kontejner

- sušicí kontejner je určený pro dlouhodobé skladování všech typů senzorů rosného bodu
- připojení ke standardní měřicí komoře pomocí vsuvky DN 7,2



Sušicí kontejner		
Obj. č.	Popis	Pro senzory
CS-06992500	sušicí kontejner pro senzory rosného bodu	všechny

Difúzní hadička

- difúzní hadička umožňuje instalaci senzoru rosného bodu ve větší vzdálenosti od potrubí
- materiál PTFE, délka hadičky 1 m, zakončení rychlospojka-vsuvka DN 7,2
- určeno pro všechny typy senzorů a instalace s tlakem do 16 bar (pro vyšší tlaky nás kontaktujte)



Teflonová difúzní hadička		
Obj. č.	Popis	Pro senzory
CS-05540003	teflonová hadička s rychlospojkou a vsuvkou, délka 1 m	všechny, s tlakem do 16 bar

Kontrolní sady

- kontrolní sady s náplní kalibračních solí pro ověření správné funkce senzoru rosného bodu ověřením vlhkosti vzorku před zahájením měření
- po ustálení by měla naměřená hodnota vlhkosti senzorem odpovídat referenční hodnotě kalibrační soli



Kontrolní sady		
Obj. č.	Popis	Pro senzory
CS-05540002	kontrolní sada 11,3 % RH	všechny
CS-05540004	kontrolní sada 33 % RH	všechny
CS-05540005	kontrolní sada 75,3 % RH	všechny

Kalibrační služby

- nabízíme možnosti různých kalibrací pro senzory rosného bodu v kalibrační laboratoři výrobce senzorů
- kalibrace senzorů rosného bodu by měla být pro zajištění správných hodnot prováděna alespoň 1 × ročně



Kalibrační služby		
Obj. č.	Popis	Pro senzory
CS-07007710	kalibrace druhého kalibračního bodu -80/+20 °C	všechny
CS-06993396	precizní kalibrace -40/+3 °C s ISO certifikátem	všechny
CS-06993333	precizní re-kalibrace -40 °C s ISO certifikátem	všechny
CS-06993900	zapůjčení monitorovací jednotky po dobu rekaliibrace	všechny
CS-06993990	zapůjčení kalibrovaného senzoru rosného bodu po dobu rekaliibrace	všechny